



ドライケム初の動物用医薬品 富士ドライケムスライド v-LIP-P

いつでも 院内のドライケムで測定可能


すぐに 測定時間 5分




イヌの膵リパーゼ免疫活性(PLI)との相関が良好*

* イヌ 65例によるPLIとの比較データ

PLIとの相関

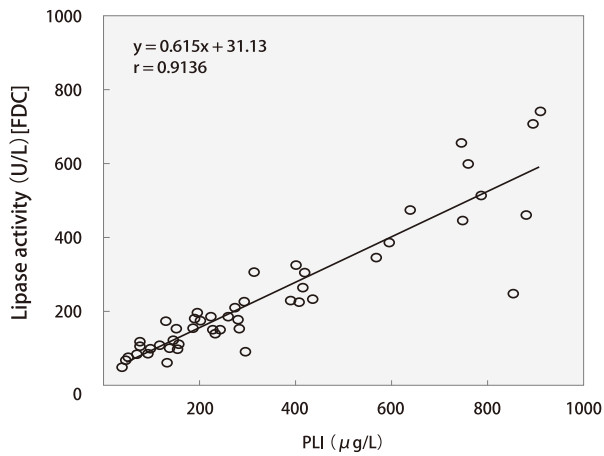

PLI診断区別のリパーゼ活性値分布

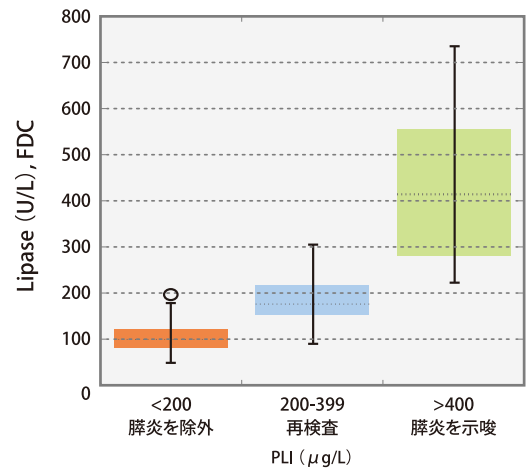

引用: Ishioka et al J Vet Med Sci(印刷中)

各種富士チューブもご用意しています

<p>富士チューブ(ブレイン) 1.5mL、0.5mL</p>	<p>富士チューブ(ヘパリン) 1.5mL、0.5mL</p>	
<p>富士チューブ(EDTA-2K) 0.5mL</p>	<p>富士チューブ(ヘパリン+分離剤) 1.2mL</p>	<p>富士チューブ(凝固促進タイプ+分離剤) 1.2mL</p>



富士ドライケムスライドv-LIP-P 薬事承認番号:22 動薬第2612号